

## 中药学院对药物化学学部科研实验室开展安全检查

按照《关于建立中药学院领导班子成员实验室安全巡查制度的通知》（中药[2021]184号）的要求，2022年3月1日下午，詹若挺院长、邓劲松书记带领平台管理办人员前往药科楼C2栋四楼五楼的药物化学学部科研实验室进行第三次的安全检查。

本次检查发现药物化学科研实验室安全管理工作整体情况良好，实验室环境卫生较整洁，前两次检查发现的安全管理问题如烘箱加热设备均已实行使用登记，研究生在实验室内着装规范，实验台面未见饮料，学生休息室及各实验室制订落实了值班制度；实验室冰箱均贴好贮存物品清单；一些团队实验室制订了本室相应的实验室管理制度并上墙，上次检查中实验室管理问题较多的C524室亦整改到位，实验室布局、用电、气体柜管理、研究生值日制等方面均有很大改善，希望各PI团队继续督促学生遵守各项规章制度养成好的安全卫生习惯、在良好的实验室环境中学习工作。

本次安全检查仍有个别细节需要加强注意，如：大多实验室未按照学院出台的假期前实验室大扫除要求对室内配套的通风抽风罩清洁除尘；个别使用酒精灯的生物安全柜旁边未放置灭火毯；个别室需长期运行处理数据的电脑主机放置位置不合理有安全隐患；一些实验室废液产生过多需加强监控管理等。

针对上述检查中发现的问题，学院领导当场知会在场人员立即整改，加强实验室安全管理。学院领导班子成员将按照《关于建立中药学院领导班子成员实验室安全巡查制度的通知》（中药[2021]184号）的要求，定期对学院全部实验室进行安全巡查，对发现的问题将及时通知整改，对存在安全隐患但不整改或整改不到位的实验室，学院将按规定给予通报批评，并按学校规定对相关负责老师和研究生进行约


谈，并将约谈记录上报学校有关部门。



学院领导检查药物化学学部科研实验室




C524 完成整改较好

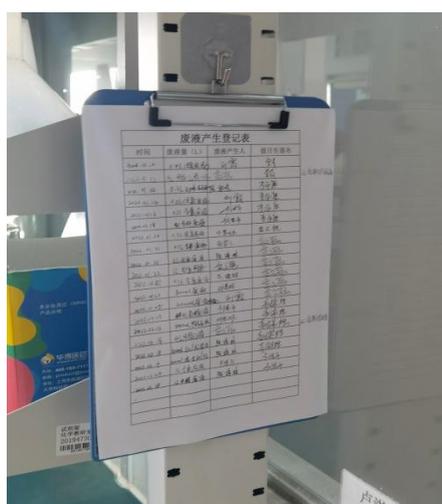

C426 有废液生产记录表




C437 进出人员登记表整改

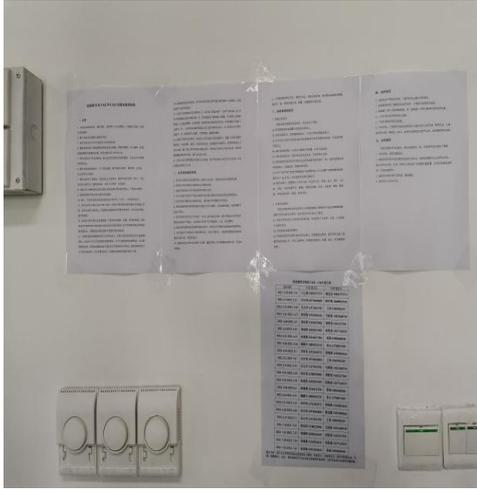

C423 实验室规章制度上墙

名称	试剂来源	CAS	储存的规格/数量
三乙氧基硼氢化钠	九鼎	56553-60-7	冰箱 54
卡宾合剂	阿拉丁	56602-33-6	冰箱 55
1,6-二肼基丙烷	菲博特	629-03-8	冰箱 87
苄基胺	九鼎	98-80-6	冰箱 114
生肌散	Sigma	58-85-5	冰箱 116
吡啶二甲基吡啶衍生物	阿拉丁	13292-87-0	冰箱 270
4-溴丁胺	阿拉丁	2369-81-5	冰箱 271
羧基咪唑吡啶衍生物	阿拉丁	14844-85-6	冰箱 272
三氯化硼 (二氯甲烷溶液)	阿拉丁	10294-33-4	冰箱 273
硼烷	阿拉丁	106-59-4	冰箱 274
β-丙氨酸乙基酯	阿拉丁	4244-84-2	冰箱 275
2,3-二氯-5,6-二氢吡啶	阿拉丁	84-58-2	冰箱 276
2,3-二氯-5,6-二氢吡啶	阿拉丁	84-58-2	冰箱 276
2,3-二氯-5,6-二氢吡啶-1,4-二酮	九鼎	84-58-2	冰箱 276
甲磺酸溶液	阿拉丁	74-89-5	冰箱 277
甲磺酸溶液	九鼎	7551-34-6	冰箱 278
4-溴二乙胺	九鼎	37465-78-4	冰箱 279
4-溴二乙胺	阿拉丁	37466-78-4	冰箱 279
4-溴-1,7-联吡啶衍生物(四氢吡啶)	阿拉丁	33336-62-3	冰箱 280
4-叔丁基胺	阿拉丁	874-61-3	冰箱 281
白藜芦醇	阿拉丁	501-86-0	冰箱 282
N-Boc-2,2'-(亚乙二氧基)二乙胺	阿拉丁	153086-78-3	冰箱 283
前体	阿拉丁	57-88-5	冰箱 284
3-乙酰氧基吡啶	阿拉丁	937-14-4	冰箱 285
1H-吡啶-1-甲磺酸盐	阿拉丁	4033-02-3	冰箱 287
氯化钠	阿拉丁	582-21-0	冰箱 288
氯化钠	阿拉丁	107-65-1	冰箱 289
1-叔丁基-3-咪唑啉酮	阿拉丁	1111-87-3	冰箱 290
1-Roc-4-吡啶甲酰胺	阿拉丁	84358-13-4	冰箱 291
吡啶二胺	阿拉丁	75-54-7	冰箱 292
吡啶二胺	九鼎	508-02-1	冰箱 293
吡啶二胺衍生物	阿拉丁	508-02-1	冰箱 293
3-叔基-4-甲氧基吡啶	Ark Pharm	517-71-5	冰箱 295
2-溴乙胺	阿拉丁	540-51-2	冰箱 296
吡啶-2-甲胺	阿拉丁	1121-60-4	冰箱 297
3-溴吡啶-2-胺	阿拉丁	79-23-5	冰箱 298
乙胺	阿拉丁	75-07-0	冰箱 299
乙胺	阿拉丁	75-07-0	冰箱 299
三氯化硼-吡啶溶液	阿拉丁	313-57-9	冰箱 300
吡啶	阿拉丁	77-52-1	冰箱 301
吡啶	阿拉丁	77-52-1	冰箱 301
2-苄基-3-吡啶-N,N,N',N'-四甲氧基吡啶硼烷	阿拉丁	121700-67-6	冰箱 302
吡啶	阿拉丁	627-19-9	冰箱 304
吡啶	阿拉丁	85-46-3	冰箱 304
吡啶	阿拉丁	61668-64-9	冰箱 305
2-叔丁基吡啶-4-甲酰胺	阿拉丁	6939-47-3	冰箱 306
吡啶	阿拉丁	14223-01-8	冰箱 307
3-溴吡啶	百奥威	106-96-7	冰箱 308


C424 冰箱清单整理清晰

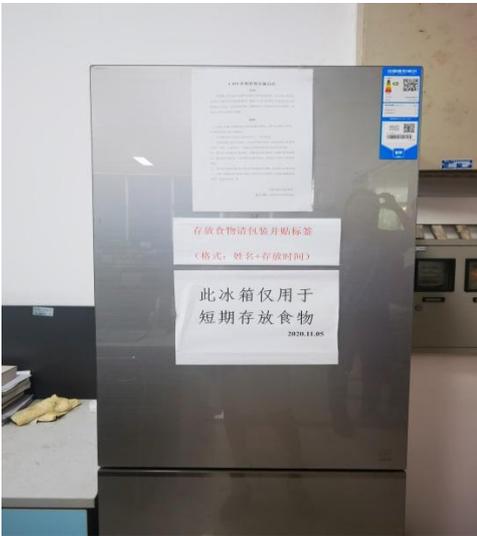

C421 学生室冰箱管理较好



C421 毕业生座位未协调管理

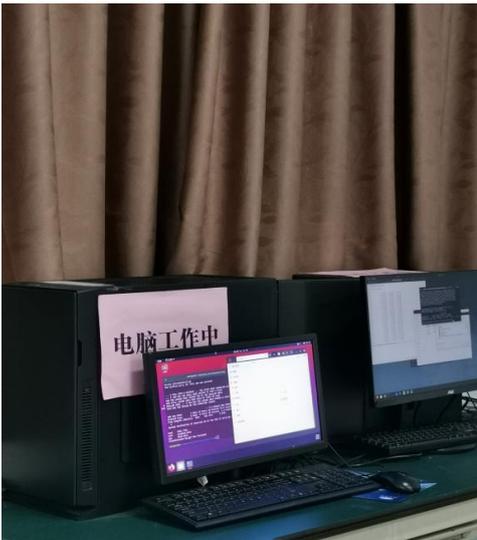

C437 电脑主机南向离窗帘较近有安全隐患



C431 安全柜旁未放置灭火毯



C431 废液存放过多未见管理制度



C430 冰箱上部积尘需清洁



C425、 C429、 C430 抽风罩脏积尘需清洁